




CROMATÓGRAFO LÍQUIDO PE-LC 75.

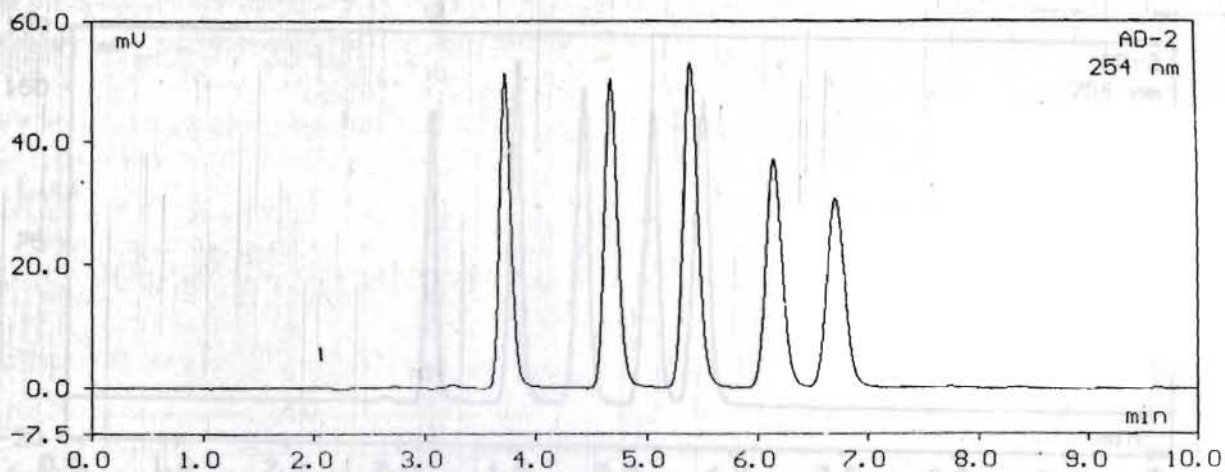

Cromatograma del test de verificación.

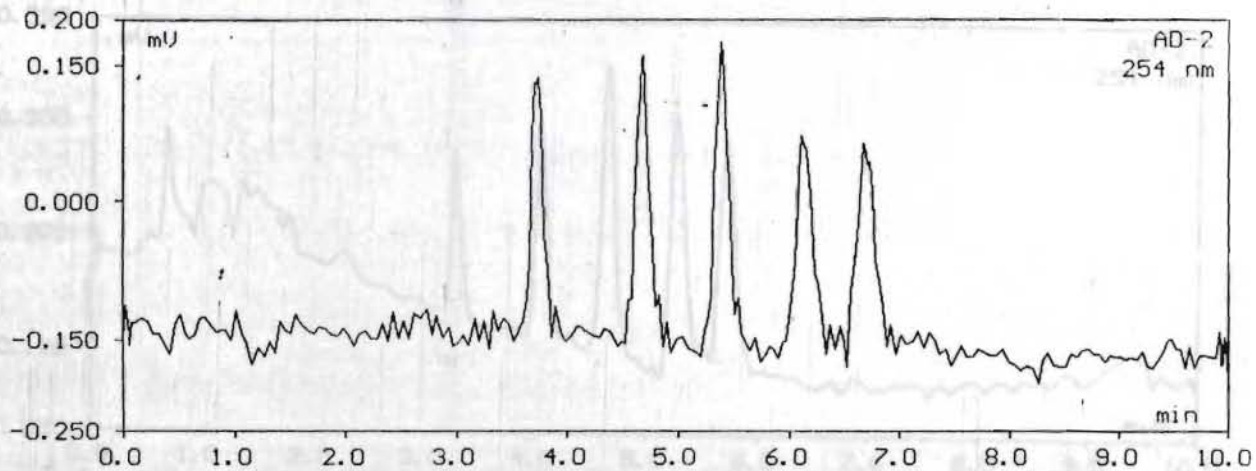


Cromatograma del límite de cuantificación.

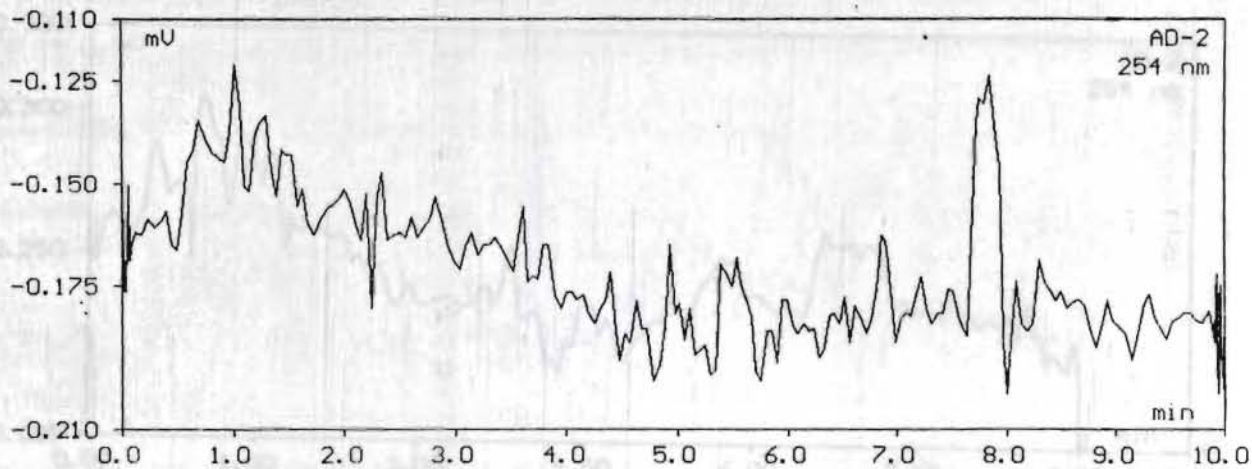


Cromatograma del ruido.


CROMATÓGRAFO LÍQUIDO PE-757 AD. TERS 440.

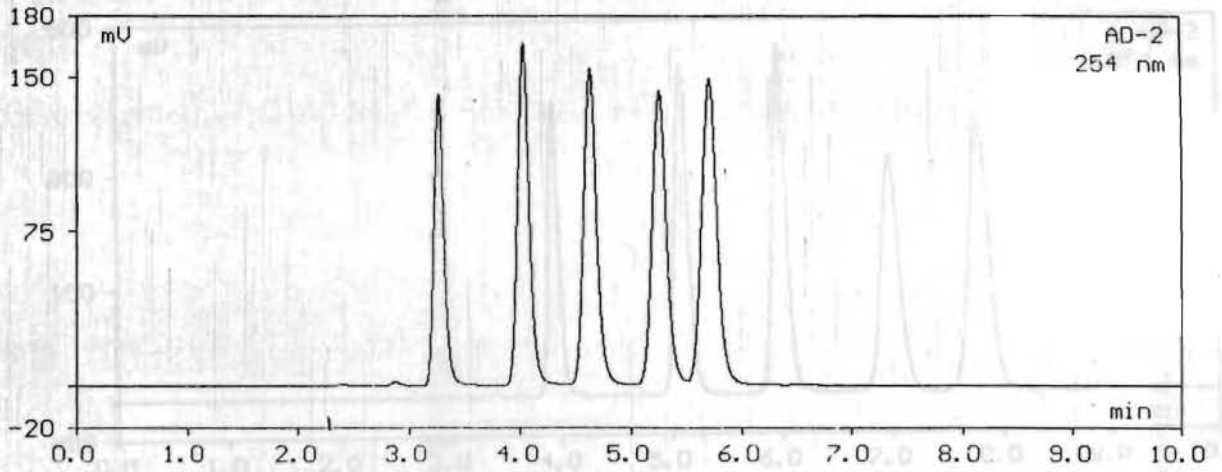

Cromatograma del test de verificación.

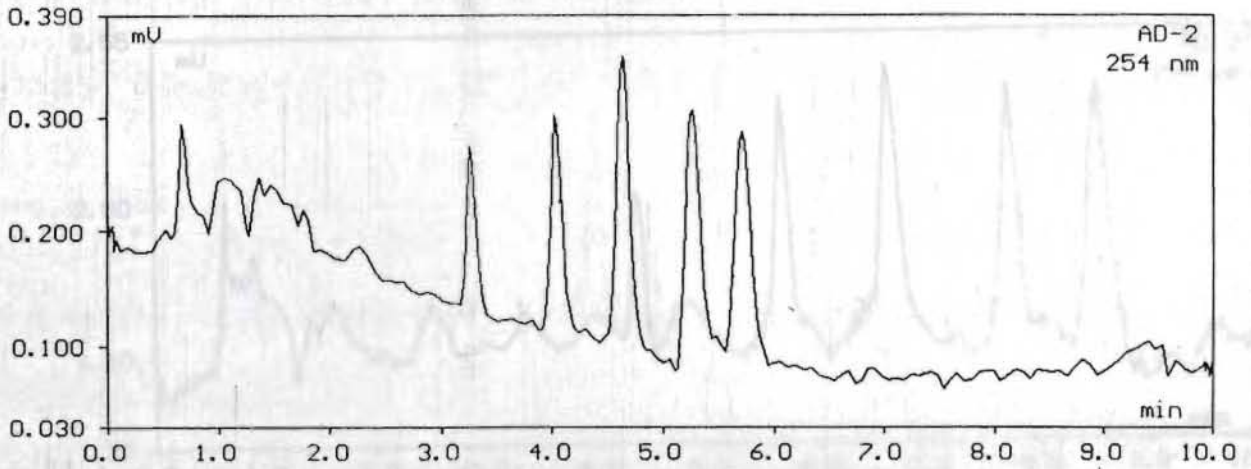


Cromatograma del límite de cuantificación.

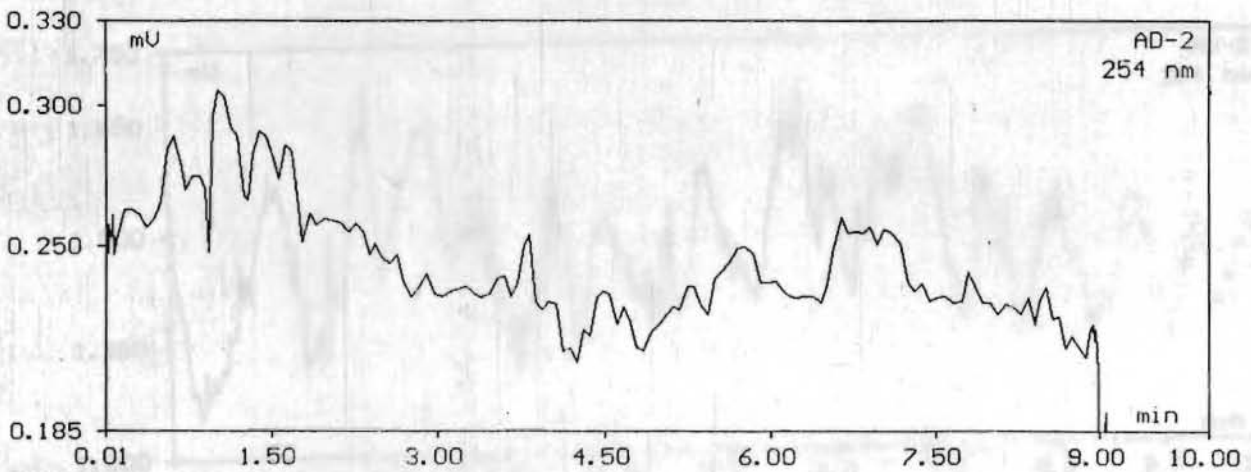


Cromatograma del ruido.


CROMATÓGRAFO LÍQUIDO KNK-WATERS 440.

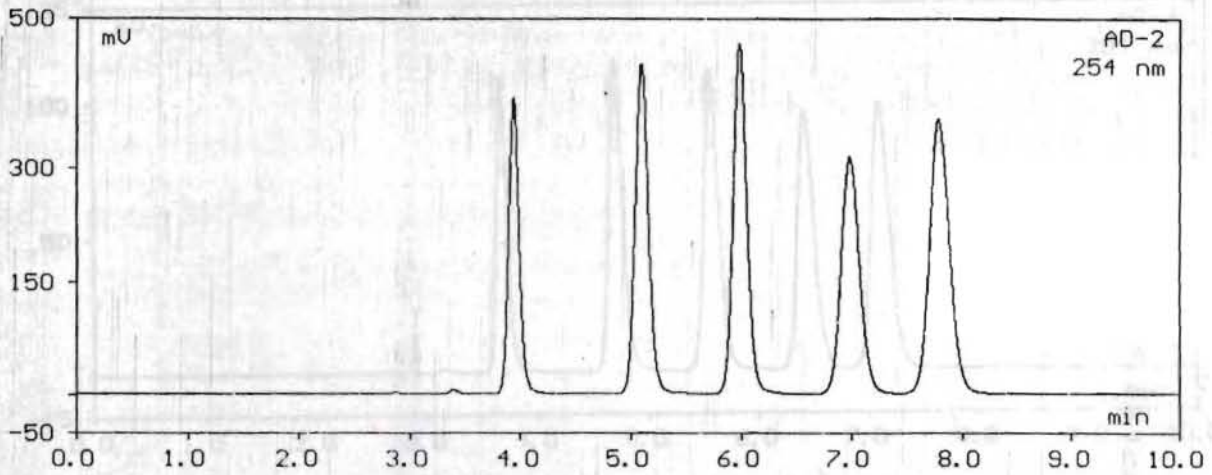

Cromatograma del test de verificación.

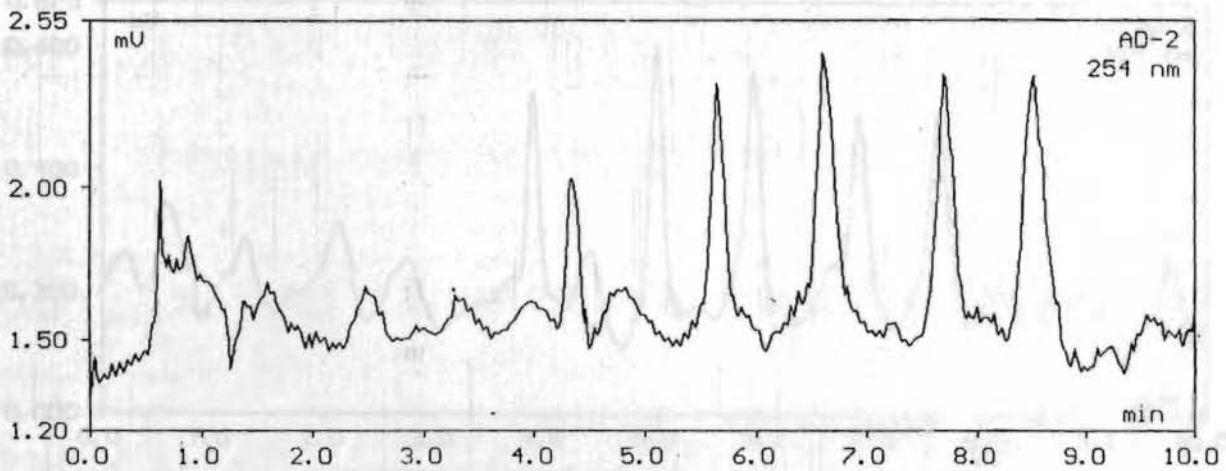


Cromatograma del límite de cuantificación.

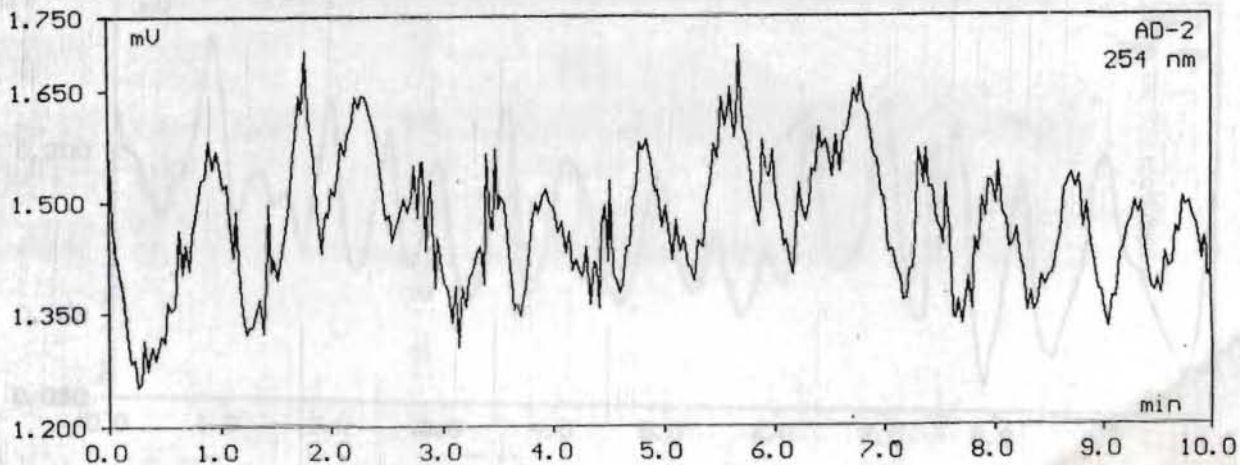


Cromatograma del ruido.


CROMATÓGRAFO LÍQUIDO KNK-757 AD.

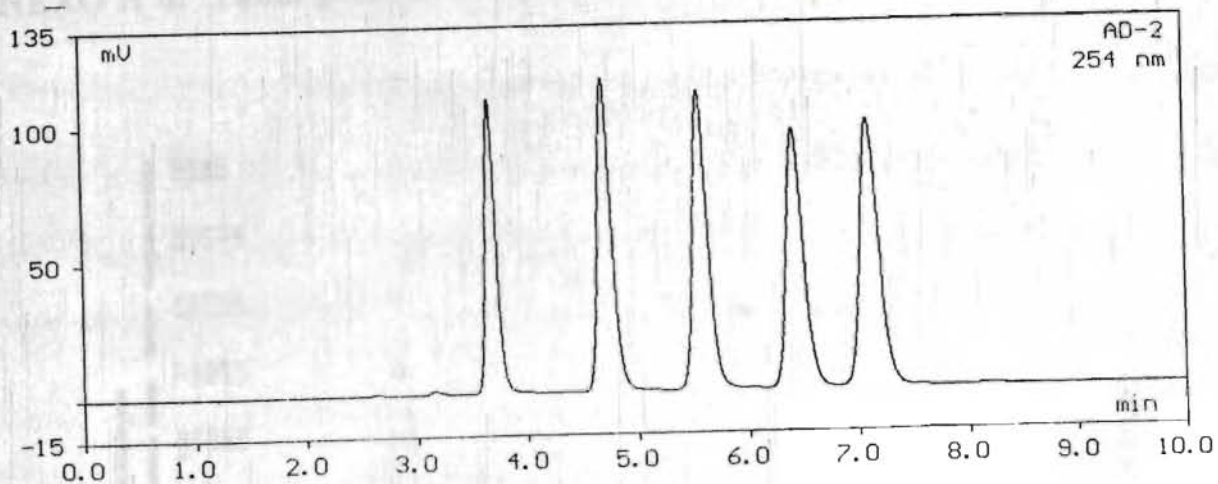

Cromatograma del test de verificación.

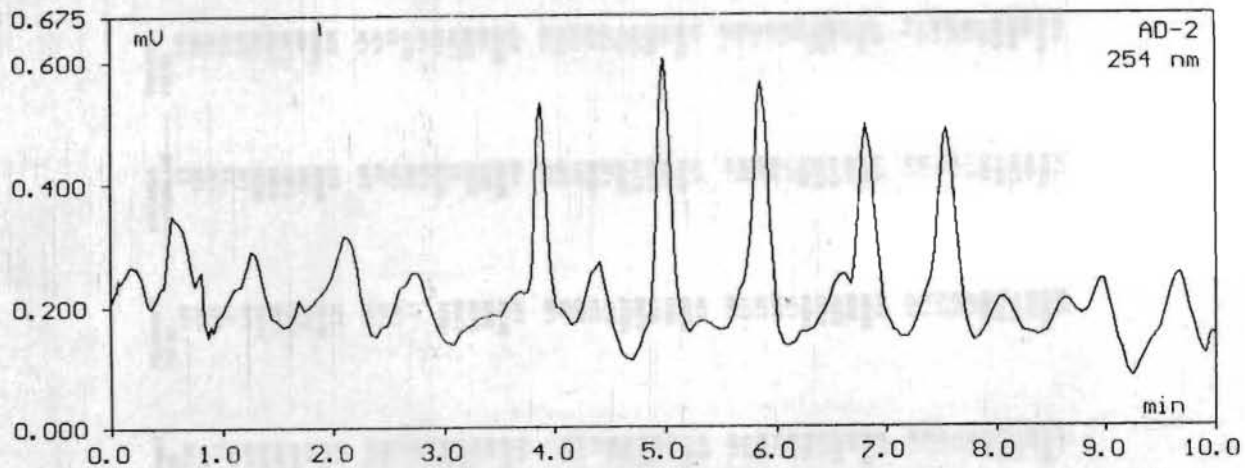

Cromatograma del límite de cuantificación.

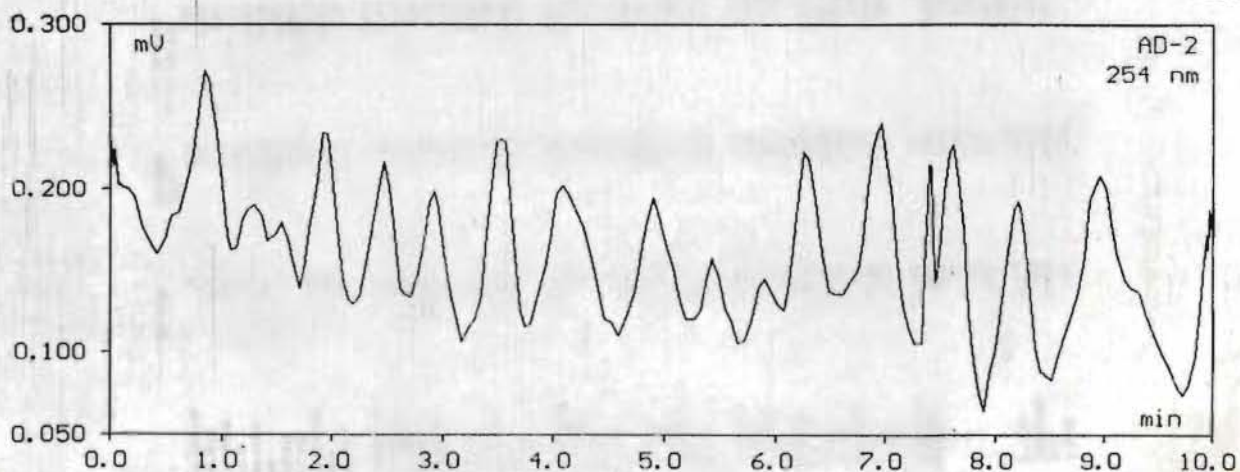

Cromatograma del ruido.

